

• **Probenmaterial:**

Kapillarblut, venöses Blut, Serum, Plasma


• **Probenanalyse mit dem F200:**

Verwenden des „Standard“ Modus: → Testkassette wird im Gerät inkubiert

1. Bereiten Sie ein STANDARD F Gerät vor und wählen Sie den **Standard** Modus aus.
2. Geben Sie die Bediener-ID und/oder Patienten-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.
3. Führen Sie die Testkassette mit dem Barcode voran in den Testschlitz des Gerätes.




4. Entnehmen Sie **5 µL** Blutprobe mithilfe des roten Sammelgefäßes.

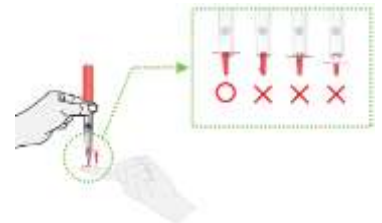

5. Mischen Sie die Probe, die Latex-Tablette und den Extraktionspuffer, durch **6-8-maliges** Drücken des roten Noppens. Vermeiden Sie Blasenbildung.



6. Entnehmen Sie die **gesamte** Probenmischung.



7. Nachdem die **gesamte** Probe auf die Testkassette gegeben wurde, drücken Sie **Start** und nach **3 min** zeigt der F200 Ihr Ergebnis an.